

한국정밀공학회 2011년도 춘계학술대회 논문집

Proceedings of KSPE 2011 Spring Conference

상

정밀가공, 로봇 제어 자동화, 생산시스템, 공작기계,
나노마이크로기술, 임의형상제조시스템, 특별세션

- 일 자 : 2011년 6월 1일(수) ~ 6월 3일(금)
- 장 소 : 라마다프라자제주호텔
- 주 최 : 사단법인 한국정밀공학회
- 후 원 : 한국과학기술단체총연합회

제주관광공사 JEJU TOURISM ORGANIZATION

LEADER LEADING INDUSTRY DEVELOPMENT IN ECONOMIC REGION 제주광역경제권 선도산업지원단

● 논문발표목차

| | | |
|--------|--|-----|
| 11S603 | 생체 삽입용 의료기기를 위한 전력 및 데이터 동시 전송 모듈 | 583 |
| | *안혜린(연세대학교), 정상훈(연세대학교), 한국과학기술연구원), 조성은(연세대학교), 서준교(한국과학기술연구원), 김용준(연세대학교) | |
| 11S604 | 실시간 환경 모니터링을 위한 기체 기반 입자 분석 칩 | 585 |
| | *김홍래(연세대학교), 박철우(연세대학교), 황정호(연세대학교), 김용준(연세대학교) | |
| 11S605 | 균일한 전계에서의 하전된 마이크로입자의 모션 모사 | 587 |
| | *김승택(한국생산기술연구원), 김형태(한국생산기술연구원), 이상호(한국생산기술연구원), 김종석(한국생산기술연구원), 박문수(한국생산기술연구원), 정훈(한국생산기술연구원), 강성복(한국생산기술연구원), 이석우(한국생산기술연구원), 조영준(한국생산기술연구원) | |
| 11S606 | 펄스 조건에 따른 갈륨비소의 산화 나노리쏘그라피 특성 | 589 |
| | *류시형(전북대학교), 김형철(전북대학교 대학원), 유종선(전북대학교) | |
| 11S607 | 인체의 움직임과 열을 이용한 PVDF 기반 에너지 수확 소자 | 591 |
| | *김명수(연세대학교), 조성은(연세대학교), 김민기(연세대학교), 김용준(연세대학교) | |
| 11S608 | 공기중 입자측정의 높은 효율을 위한 초소형 멀티팁 코로나 방전기 | 593 |
| | *변석영(연세대학교), 김용준(연세대학교), 김홍래(연세대학교) | |
| 11S609 | Sharp-Ridge 나노개구의 경사면에 의한 광특성 분석 | 595 |
| | *최국종(연세대학교), 박노철(연세대학교), 이원섭(연세대학교), 김태섭(연세대학교), 박경수(연세대학교), 박영필(연세대학교) | |
| 11S610 | Nano Cavity 유동의 분자동역학 해석을 통한 폴리머 Melting point 예측 | 597 |
| | *김석범(서울대학교), 정재민(서울대학교), 이동언(서울대학교), 문성남(서울대학교), 이우일(서울대학교) | |
| 11S611 | MEMS 공정을 이용한 미세바늘 제조 및 성능평가 | 599 |
| | *성연욱(한국생산기술연구원), 박진호(한국생산기술연구원), 송정한(한국생산기술연구원), 이낙규(한국생산기술연구원), 이해진(한국생산기술연구원) | |
| 11S612 | 하이브리드 공정을 이용한 다중 연결 ZnO 나노와이어 패턴 제작 | 601 |
| | *이지혜(한국기계연구원), 이원석(한국과학기술원), 박인규(한국과학기술원), 최대근(한국기계연구원), 이응숙(한국기계연구원), 정준호(한국기계연구원) | |
| 11S613 | PCR 반응을 위한 Peltier의 발열 특성 연구 | 603 |
| | *김한희(한국산업기술대학교), 강병훈(한국산업기술대학교), 고인덕(전남대학교), 김상희(전남대학교), 강대진(한국산업기술대학교) | |
| 11S614 | 압저항형 마이크로 캔틸레버를 이용한 원자현미경 시스템 제작 및 특성평가 | 605 |
| | *박창신(전남대학교), 이동원(전남대학교) | |
| 11S615 | Micro-CMM용 고민감성 진동 프로브의 설계 | 607 |
| | *변정웅(고려대학교), 정재화(고려대학교) | |
| 11S616 | UV 레이저(355nm)를 이용한 금속박막 미세가공 공정의 해석모델 | 609 |
| | *이정한(부산대학교), 오재용(부산대학교), 박상후(부산대학교), 신보성(부산대학교) | |
| 11S617 | Chevron형의 열구동기가 집적화된 대변형 XY-마이크로스테이지 | 611 |
| | *최영수(전남대학교), 이동원(전남대학교) | |
| 11S618 | UV 레이저 빔의 에너지 프로파일 변화에 따른 폴리이미드 표면 개질 특성 연구 | 613 |
| | *오재용(부산대학교), 신보성(부산대학교), 박덕수(부산대학교) | |
| 11S619 | Graphene 산화 Thinfilms의 전기 수송 특성 | 615 |
| | *김상재(제주대학교), Gunasekaran Venugopal(제주대학교) | |

압저항형 마이크로 캔틸레버를 이용한 원자현미경 시스템 제작 및 특성평가

Fabrication and Characterization of the Atomic Force Microscope system with piezoresistor micro cantilever

*박창신¹, #이동원²

*C. S. Park¹, #D. W. Lee(mems@jnu.ac.kr)²

^{1,2}전남대학교 기계공학과

Key words : Piezoresistor, SPM, AFM, micro cantilever

1. 서론

원자현미경(Scanning Probe Microscope, 이하 SPM)은 진공상태나 대기 중 뿐 아니라 액체 내에서도 작동해 살아있는 세포내의 구조나 세포분열 등을 관찰할 수 있으며, 전자현미경(SEM)이 진공 상태에서만 가능하다는 것을 감안하면 SPM은 응용 범위가 넓다. 광학현미경의 배율이 최고 수천 배, SEM의 배율이 최고 수십만 배인데 비해 SPM의 배율은 최고 수천만 배로써 개개의 원자를 관찰할 수 있는 분해능을 가지고 있으며, 나노 단위에서 온도 분포, 표면 전계 및 자계 형상 등을 3차원적으로 분석할 수 있기 때문이다. 이에 반해 투과식 전자현미경인 TEM은 수평방향의 분해능이 SPM과 유사하나 수직방향의 분해능이 훨씬 떨어지는 단점이 있다. SPM의 수직방향 분해능은 수평방향보다 더욱 좋아서 원자 지름의 수십 분의 일(0.01nm)까지도 측정해 낼 수 있는 것으로 알려져 있으며[1], 주사 터널링 현미경(Scanning Tunneling Microscope: STM)과 원자 힘 현미경(Atomic Force Microscope: AFM)등의 SPM 종류로만 가능하다.

SPM은 높은 분해능을 얻기 위하여 몇 가지 중요한 기술을 필요로 한다. 매우 날카로운 탐침을 갖는 마이크로 캔틸레버(Micro cantilever) 제작 기술, 진동차단 및 감쇄 기술, 3차원 주사장치의 교정, 그리고 전자제어회로 기술 등이 매우 중요하다. 이러한 SPM의 중요기술들은 현재 많은 연구와 개발에 의하여 원자수준의 정밀측정이 가능하지만 고가의 장비들과 부가적인 복잡한 기기들로 구성이 되어 있어 보편성이 떨어지며, 전문가가 아니면 활용이 어려운 실정이다.

본 연구에서는 기존의 SPM과 유사한 분해능을

갖지만 부가적인 장비들과 복잡한 구성을 간소화 한 새로운 AFM 시스템에 관하여 제안하고자 한다. 기존의 AFM에 사용되는 마이크로 캔틸레버 및 광학식 변위 측정 방식 대신에 압저항(piezoresistor) 센서가 집적화된 마이크로 캔틸레버와 디지털 측정 방법을 이용함으로써 가능하다.

2. 원자현미경 시스템 제작 및 특성평가

그림 1(a)는 제안된 AFM 시스템을 간략하게 나타낸 구성도이다. 마이크로 탐침의 정밀한 3차원 구동/제어를 위한 스캐너(PZT), 대변위의 Z축 구동을 위한 액츄에이터, 진동 차단을 위한 Damper 등으로 구성되어 있으며, 그림 1(b)는 본 연구진이 설계/제작한 AFM을 나타낸다. 그림 1(c)는 압저항 센서가 집적화된 마이크로 캔틸레버의 SEM 이미지이며, 저항체는 $600\Omega \pm 50\Omega$ 로 설계되었다. 고감도 센서가 집적화된 캔틸레버를 사용하여 전체적인 AFM 시스템을 간소화하였으며, 집적화된 센서는 외부응력에 따라 저항값이 변화하는 압저항 원리를 이용하였다. 그림 2는 제작된 AFM을 기준의 측정 방식과 본 연구에 사용된 측정 방식에 대한 개념도를 나타낸다. 일반적인 AFM은 마이크로 캔틸레버의 변위 검출을 위하여 광학식 변위 측정 방식으로 포토다이오드를 이용한다. 마이크로 캔틸레버 끝단에 레이저를 고정하여 캔틸레버의 변위를 전기적 신호로 변환하여 측정하며, 이 전기적 신호를 아날로그 방식인 전기적 회로를 이용하여 증폭과 노이즈 차단과 같은 후처리 과정을 거친다. 하지만 본 연구에서는 후처리 과정을 레이저 변위계(Laser vibrometer)를 이용하여 AFM이 사용되는 장소와 시스템 내의 진동을 분석 하였다. 그리고

일반적인 아날로그 전기회로와 같은 후처리 과정으로 프로그램 내에서 디지털화하여 FFT 방식의 노이즈 분석과 차단을 빠르게 처리하였으며, 표 1에 스캐너의 속도에 따른 진동결과를 나타내었다. 스캔속도가 낮을수록 진동에 대한 노이즈는 안정적이며, 제안된 AFM 시스템은 최소 67Hz 정도의 진동 노이즈가 있음을 확인하였다. 또한 진동에 대한 분석 결과와 전기적 노이즈를 Low & High cut-off 방식으로 67 Hz 범위 내에서 제어하여 3차원적인 샘플의 이미지를 측정하였다. 그림 3(a)는 디지털 방식으로 사용된 FFT 진동분석 결과를 나타내며, 그림 3(b)는 사용된 200nm 두께의 금속이 코팅된 실리콘 기반 샘플의 SEM 이미지이다. 스캐닝된 부분은 금속의 두께가 포함된 $10\mu\text{m}^2$ 의 영역이다. 그림 3(c)와 (d)는 디지털 노이즈 차단 전과 후의 3차원 이미지를 나타낸다. 실제 샘플의 형상과 디지털 노이즈 필터링을 이용한 형상과는 $\pm 6\text{nm}$ 오차율 내에서 깨끗한 3차원 이미지화(10kS/s)를 성공하였으며, 사용된 마이크로 캔틸레버의 감도는 약 $4.2 \times 10^{-6} \Delta R/R/\text{nm}$ 이다.

3. 결론

본 연구에서는 기존 AFM의 복잡한 시스템 구성을 압저항형 마이크로 캔틸레버를 이용하여 간소화하고, 진동 및 전기적 노이즈를 분석하여 디지털 방식으로 3차원 이미지를 볼 수 있는 AFM 시스템 제작 및 특성평가를 수행하였다.

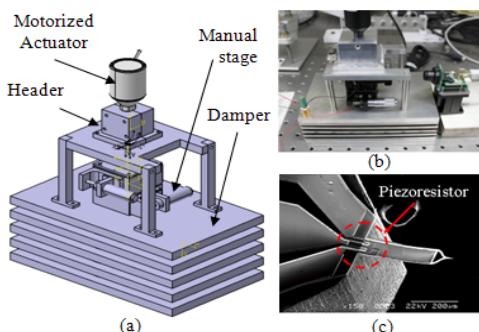


Fig. 1 (a) Schematic and (b) optical images of home-made AFM system, (c) SEM image of a micro cantilever with integrated piezoresistor

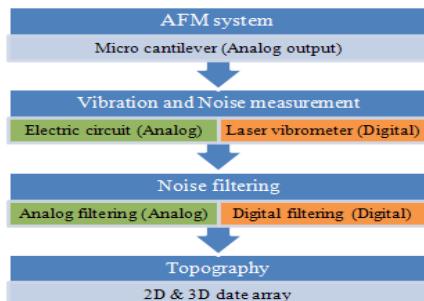


Fig. 2 Analog and digital measurement method of mechanical vibration and electric noise

Table 1. Result of FFT analysis according to scan speed

| Scan speed (mm/S) | FFT(Hz) | Scan area/(μm^2) |
|-------------------|---------|-------------------------------|
| 500 | 200 | |
| 100 | 100 | |
| 50 | 70 | 10 |
| 10 | 67 | |

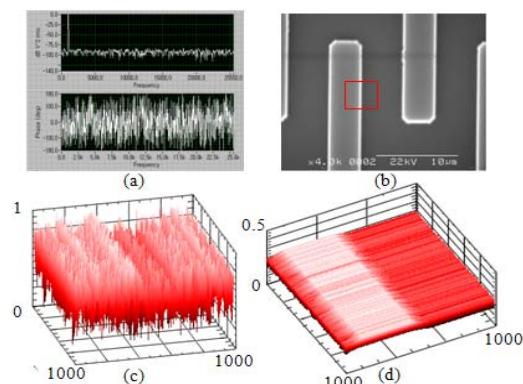


Fig. 3 (a) Digital noise filter, (b) SEM image of sample, (c) Before and (d) after digital filtering of scanning image

Acknowledgements

This work was supported by the National Research Foundation (NRF) (No.2007-0056959) and the WCU (R32-200871) program funded by the Korea government (MEST).

참고문헌

1. L. Howald, and H. J. Guntherodt, "Atomic-force microscopy on the Si(111) 7 X 7 surface", Physical review B, 15, 5485- 5487, 1995.